



ที่ มส ๐๐๓๓.๐๐๓/๑๙๓๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส.๕๘๐๐๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวชกรรม
และการคัดกรองความพิการทารกในครรภ์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. เอกสารประชาสัมพันธ์

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวชกรรม และการคัดกรองความพิการทารกในครรภ์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาทักษะหัตถการในการตรวจอัลตราซาวด์ทางสูตินรีเวช อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดจัดประชุมในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโยธี ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอประชาสัมพันธ์การประชุมฯ ดังกล่าว ให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน ร่วมการประชุมฯ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๒๐๐ บาท และเงื่อนไขการสมัครดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการจากต้นสังกัดและไม่ถือเป็นวันลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร สุวรรณมังกร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทร. ๐-๕๓๖๑-๑๒๘๑ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐-๕๓๖๑-๑๓๒๒

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการอัลตราซาวด์ทางสูตินรีเวช

Mastering OB-GYN Ultrasound: A Comprehensive Guide to Diagnostic Excellence

วันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ห้องประชุมโยธี ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสูตินรีเวชศาสตร์

หน่วยอัลตราซาวด์ทางสูตินรีเวช กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

วัน/เดือน/ปี / เวลา	รายละเอียด	วิทยากร
วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๗		
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐	ลงทะเบียน	
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐	กล่าวรายงาน - พิธีเปิด	
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐	Imaging Optimization	ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรศักดิ์ จันทรวงศ์อร่าม
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐	Coffee break ชมนิทรรศการ	
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐	Uterus and Endometrium ultrasound	อ.นพ. สมชาย ศิริเจริญไทย
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐	The ultrasound for fertility planning	อ.พญ. สิตานัน เลิศศิริพานิชย์
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐	พักรับประทานอาหารกลางวัน	
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐	Ovary and adnexal ultrasound	ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.มรุต ญาณารณพ
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐	Coffee break ชมนิทรรศการ	
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐	Hands on Gynecologic ultrasound	MFM team

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการอัลตราซาวด์ทางสูตินรีเวช

Mastering OB-GYN Ultrasound: A Comprehensive Guide to Diagnostic Excellence

วันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ห้องประชุมโยธี ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสูตินรีเวชศาสตร์

หน่วยอัลตราซาวด์ทางสูตินรีเวช กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

วัน/เดือน/ปี / เวลา	รายละเอียด	วิทยากร
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗		
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐	First Trimester Ultrasound	อ.พญ. ลัธรพร พัฒนาวิจารย์
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐	Second trimester anomalies screening	อ.พญ. สุกานดา เมธีไตรรัตน์
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐	Coffee break ชมนิทรรศการ	
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐	Basic fetal cardiac screening	อ.นพ. ปรุพห์ สนั่นรัตน์
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐	Cervical length measurement and preterm prevention protocol	อ.พญ. พลอยภัสสร เพ็ญมาศ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐	พักรับประทานอาหารกลางวัน	
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐	Placenta accreta spectrum	อ.พญ. พุทธิพร ทองพั่ง
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐	Coffee break ชมนิทรรศการ	
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐	Hands on: - Umbilical artery Doppler - Middle cerebral artery Doppler - Fetal cardiac screening - Second trimester screening - Cervical length measurement	MFM team






อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจอัลตราซาวด์ทางสูตินรีเวช

โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

Mastering OB-GYN Ultrasound: A Comprehensive Guide to Diagnostic Excellence

ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2567
ณ ห้องประชุมโยธี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

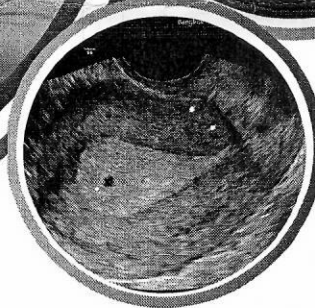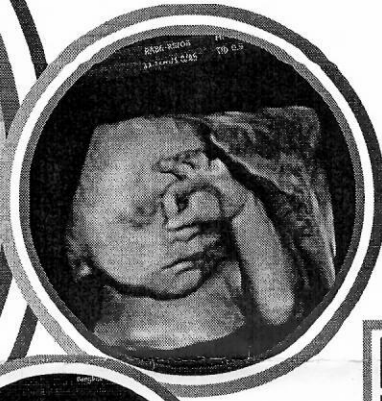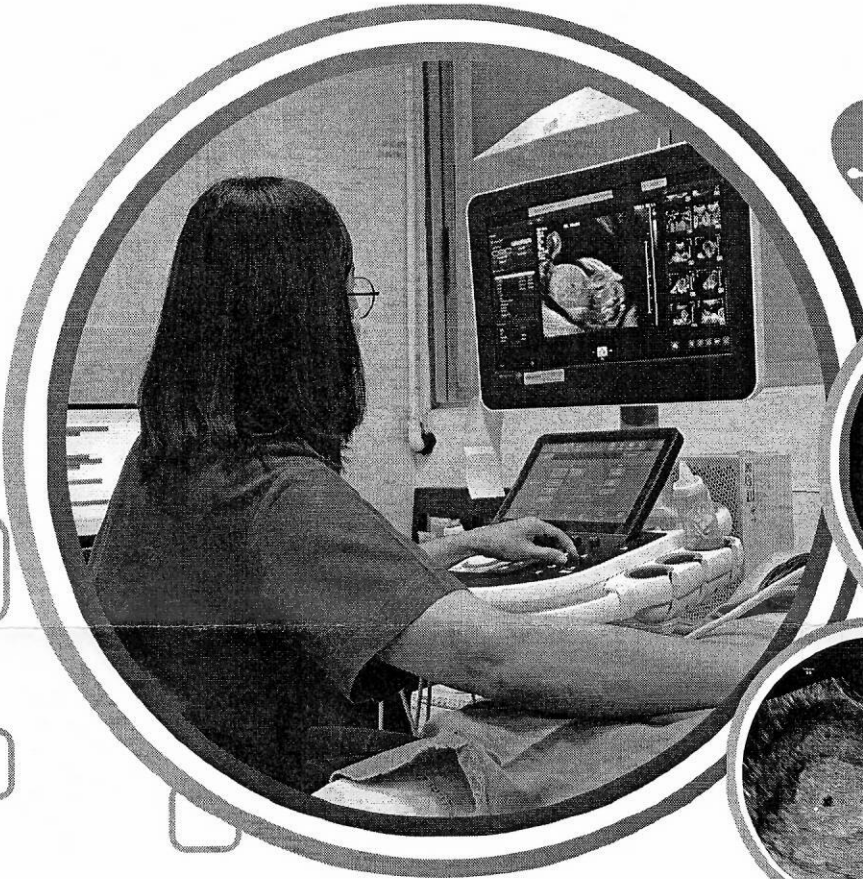

WWW.PMDRJ.COM/OBGYN

SCAN สมัครง่าย

ค่าลงทะเบียนท่านละ
1,200 บาท

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

Email: coe.ob.gyn@gmail.com ☎ 0 2206 2957

นายจักรพงศ์ แจ่มแจ้ง, นางพัชรภา เลิศกิจประเสริฐ



*** หมายเหตุ

มีหน่วยคะแนนการอบรมต่อเนื่อง
สำหรับแพทย์ (CME) กรุณากรอกข้อมูล
ของท่านในระบบลงทะเบียนให้ครบถ้วน